

ПРОБООТБОРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ СПО



ПРОБООТБОРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

ОТ КОМПАНИИ «НТА-ПРОМ»



Пробоотборные цилиндры со смонтированной запорной арматурой и дополнительными опциями могут поставляться вместе с СПО и отдельно.

Стандартные размеры пробоотборных цилиндров, мл: 50; 75; 150; 300; 400; 500; 900; 1000; 1500; 2250; 3785.

Разные серии клапанов.


Угловые или прямые клапаны.

Комплектующие с сертификатом NACE.

Сульфинертное покрытие комплектующих, контактирующих со средой.

Цилиндры с направляющими роликами для СПО конструкции «НТА-Пром».

ГАБАРИТЫ

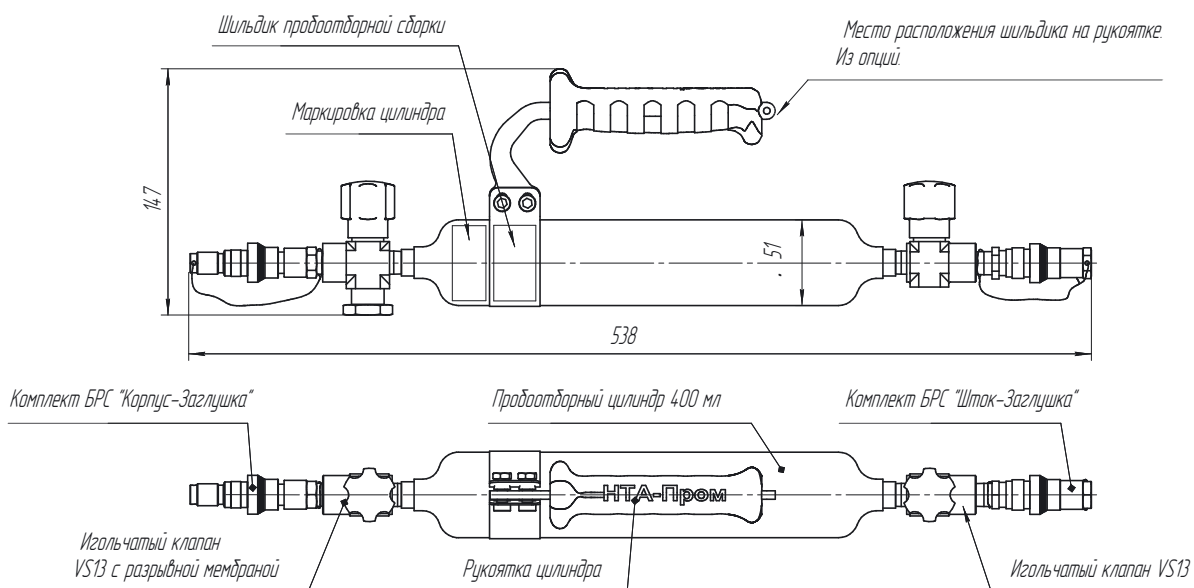

ВИДЫ ЦИЛИНДРОВ

Цилиндр с продувочной линией.

Применяется в СПО с продувкой инертным газом или промывкой растворителем.

Схемы: G/L: 1.1; 2.1; 3.1.



Цилиндр без продувочной линии.

Схемы: G/L: 1; 2; 3; 4.



АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ РУЧКА ДЛЯ ЦИЛИНДРА

позволяет тактильно убедиться в правильности хвата при переноске (иначе будет неудобно держать в руке), обеспечивается правильная развесовка цилиндра и правильность установки цилиндра в СПО.

Имеет эргономичный профиль и устанавливается с учетом направления потока при заполнении цилиндра.

На торце ручки предусмотрена возможность крепления маркировочной таблички с указанием необходимой информации о хранящейся в цилиндре пробы.

Расположение ручки пробоотборного устройства относительно штуцеров быстросъемных соединений позволяет оператору позиционировать пробоотборное устройство в направлении корпусов быстросъемных соединений, закрепленных на устройстве бесшлангового подключения и задать наиболее выгодное положение.



Анатомическая теплоизоляционная ручка



П-образная рукоятка*

ОПЦИОНАЛЬНО

- Пробоотборные цилиндры опционально могут быть поставлены с сульфидостойким покрытием. Покрывается не только сам цилиндр, но и все компоненты, которые контактируют со средой.
- Дополнительно обезопасить сотрудника от ошибки установки цилиндра в неправильном направлении, можно установив БРС на цилиндре и на СПО в определённой последовательности.
- Для увеличения срока службы БРС, которыми комплектуются цилиндры, устанавливают защитные колпаки.



Цилиндр в сборе с сульфидостойким покрытием, с защитными колпаками для БРС.

*П-образная рукоятка традиционной конструкции также доступна для заказа.

ПРИМЕР ЗАКАЗНОГО КОДА

Выберите необходимый объем цилиндра, тип клапана, материал цилиндра и арматуры, опции в нижеуказанном порядке.

SC—0400—S—N—1—SV—Y—N—S—N0—E—Y—

Цилиндр

0050 – 50 мл
0075 – 75 мл
0150 – 150 мл
0300 – 300 мл
0400 – 400 мл
0500 – 500 мл

0900 – 900 мл
1000 – 1000 мл
1500 – 1500 мл
2250 – 2250 мл
3785 – 3785 мл

Материал корпуса цилиндра

S – Нержавеющая сталь марки 316

Клапан угловой

Y – Да | N – Нет

Клапан серия

1 – VS13 | 2 – V15 | 3 – V16 | 4 – VB16

Серия БРС или наружная резьба

SV – DQ
DV – DQ с отсечением
DF – DF
SN – Для накидной гайки

N1 – NPT 1/4
N2 – NPT 1/2
G1 – G 1/4
G2 – G 1/2

Защитный колпак для БРС или для наружной резьбы

Y – Да | N – Нет

Ролик

Y – Да | N – Нет

Ручка

N – Нет
H – П-образная
E – Эргономичная

Трубка от перелива

T0 – 0%
T1 – 10%
T2 – 20%
T3 – 30%
T4 – 40%
T5 – 50%

Материал корпуса арматуры

S – Нержавеющая сталь марки 316
B – Латунь
M – Сплав 400

Продувка

Y – Да | N – Нет

GH – Шильдик с гравировкой на рукоятке*

RD1 – Разрывная мембрана 137 бар

RD2 – Разрывная мембрана 192 бара

GS – Гравировка на цилиндре

CI – Цилиндр с сульфинертным покрытием

ОПЦИОНАЛЬНО

GS – Исполнение под сернистые газы

VI – Арматура с сульфинертным покрытием**

* - Шильдик закреплен на проволоке к рукоятке за специальное ушко.

** - Покрытие совместимо с материалом арматуры из нерж. стали 316.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОБООТБОРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ



* — поля, обязательные для заполнения!

Общая информация, контакты:	
Организация*:	Дата заполнения:
Контактное лицо*:	Телефон*:
Адрес:	E-mail:
Позиции приборов по проекту (TAG):	
Место установки приборов (участок, агрегат):	Количество*:

Параметры среды:				
Рабочая среда:				
Фаза среды:	☐ Газ	☐ Жидкость	☐ Пар	
Рабочее давление:	Мин.	Раб.	Макс.	Бар
Рабочая температура:	Мин.	Раб.	Макс.	°C

Пробоотборный цилиндр:							
Объем цилиндра:	☐ 50	☐ 75	☐ 150	☐ 300	☐ 400	☐ 500	мл.
	☐ 900	☐ 1000	☐ 1500	☐ 2250	☐ 3785		
Серия вентиля:	☐ VS13 ☐ V15 ☐ V16 ☐ VB16						
Разрывная мембрана:	☐ Да	Давление разрыва: ☐ 137 ☐ 192				Бар	
Трубка от перелива:	☐ Да						
Значение перелива:	☐ 10	☐ 20	☐ 30	☐ 40	☐ 50	Другое:	%
Продувка (для СПО* с продувкой):	☐ Да (Рис. 3)						
Способ подключения цилиндра к системе:	Серия БРС: ☐ DF ☐ DQ ☐ DQ с обратным клапаном						
	☐ Наружная резьба G 1/2 ☐ Другое:						
Специальное покрытие:	☐ Сульфинерт (Рис. 1)						
Ручка цилиндра:	☐ Нет ☐ П-образная металлическая ручка						
	☐ Анатомическая теплоизолирующая ручка (Рис. 3)						
Защитный колпак БРС:	☐ Да (Рис. 2)						
Лазерная гравировка:	☐ Да	Текст:					
Табличка на хомуте:	☐ Да	Текст:					

* - Система пробоотбора (СПО).

Дополнительные опции:			
Комплектация изделия дополнительным ЗИП:	☐ Да	Перечень ЗИП:	
Сертификация:	☐ ТР ТС 010	☐ ТР ТС 012	☐ ТР ТС 032
Сертификат NACE MR0175/ISO 15156:	☐ Да		
Сертификат на материалы EN10204 3.1:	☐ Да		

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ:

- Пробоотборный цилиндр в сборе с арматурой;
- Комплект эксплуатационной документации:
 - Паспорт;
 - Руководство по эксплуатации.
- ЗИП - 0.

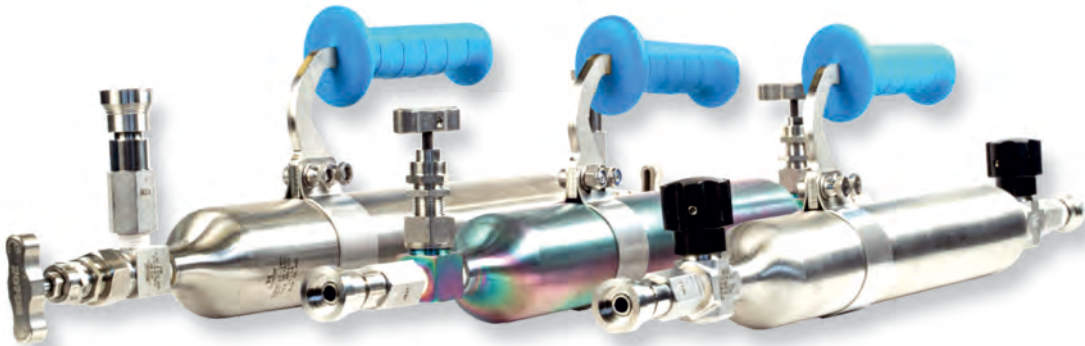


Рис. 1 Пробоотборные цилиндры.
Посередине цилиндр с сульфидостойким покрытием, по краям-без покрытия.



Рис. 2. БРС с защитным колпаком БРС.

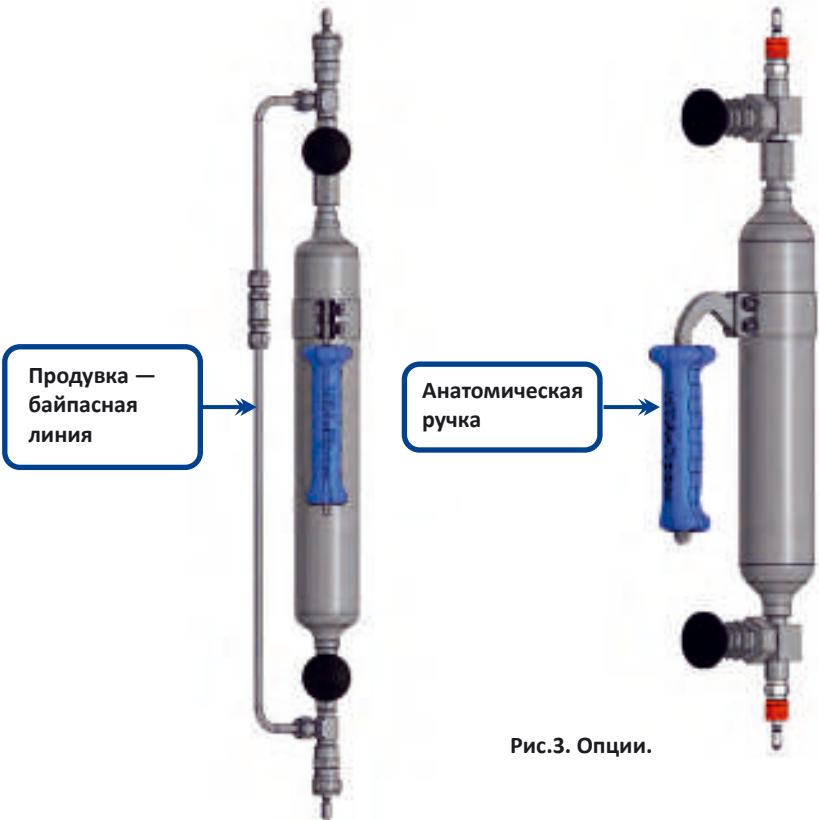


Рис.3. Опции.

Заполнение опросного листа не означает принятия каких-либо обязательств.

ООО «НТА-Пром»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: zakaz@nta-prom.ru

ЭСКИЗ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin, light gray horizontal and vertical lines. The grid consists of small squares covering the entire area of the page.

Заполненный опросный лист направляйте на единый электронный адрес zakaz@nta-prom.ru

ООО «НТА-Пром»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: zakaz@nta-prom.ru

WWW.NTA-PROM.RU



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «НТА-ПРОМ»

- ОБЖИМНЫЕ И РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
- КЛАПАНЫ И ВЕНТИЛЬНЫЕ БЛОКИ
- ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА И ШЛАНГИ
- РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
- ПРОБООТБОРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ
- МАНОМЕТРЫ И ТЕРМОМЕТРЫ
- РАСХОДОМЕРЫ
- СИСТЕМЫ ПРОБООТБОРА
- ПУЛЬТЫ И ПАНЕЛИ РЕДУЦИРОВАНИЯ
- СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ ГАЗА
- ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

НТА-ПРОМ

www.nta-prom.ru

Тел./Факс: +7 (495) 363-63-00

Эл.почта: zakaz@nta-prom.ru



Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы необходимо оценивать всю систему в целом, в том числе соблюдать назначение конкретных устройств, совместимость материалов, надлежащие эксплуатационные параметры, производить монтажные работы, эксплуатацию и обслуживание в соответствии с нормативными требованиями, что в совокупности относится к обязанностям проектировщика и конечного пользователя системы.

Информация в каталоге носит справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 435 и/или ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сопровождающие товар фотографии являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара. Любые характеристики товара, включая внешний вид, могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.

Для получения точной информации о товаре, его наличии, характеристиках и ценах, отправьте, пожалуйста, запрос нашему специалисту.